

JARAGUÁ MERCANTIL - EIRELI.

EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES



Cambe (PR), 11 de Agosto de 2.021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
ESTADO DO CEARÁ
Rua Ivete Alcântara, n.º 120 – Centro
CEP: 62.670-000 – SÃO GONÇALO DO AMARENTE / CE.

REF: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 044/2021 – SRP
ENCERRAMENTO: 12/08/2021 – ÀS 09h30min.
INÍCIO DOS LANCES: 12/08/2021 – ÀS 09h31min.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO....: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL LUIZA ALCANTARA E SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPAIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE, CONFORME PROPOSTA Nº 12045.640000/1190-01 DO MUNISTERIO DA SAÚDE. (AMPLA PARTICIPAÇÃO DE COTAS RESERVADA PARA ME/EPP), TUDE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL.


Prezados Senhores:-

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.S.as., nossa proposta comercial de preços para fornecimento dos produtos abaixo descritos:

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	VR. UNITÁRIO	VR. T O T A L
001	001	UND	AUTOCLAVE HORIZONTAL AUTOMÁTICA CAPACIDADE 250 LITROS C/02 PORTAS DEZLIZANTES VERTICAL AUTOMÁTICA (GUILHOTINA) SISTEMA DE BARREIRA MODELO: MV 250 MARCA: "MIRAX" PROCEDENCIA: Nacional. REGISTRO ANVISA: 80162700002	R\$ 211.995,00	R\$ 211.995,00
DESCRIPTIVO TÉCNICO					
AUTOCLAVE HORIZONTAL AUTOMÁTICA CAPACIDADE 250 LITROS C/02 PORTAS DEZLIZANTES VERTICAL AUTOMÁTICA (GUILHOTINA) SISTEMA DE BARREIRA Especificações: Câmara: <ul style="list-style-type: none">▪ Câmara interna com seção transversal quadrada, construída em chapas de aço inoxidável AISI 316-L, com espessura de 6 mm.▪ Câmara externa em aço inoxidável AISI 316-L com espessura de 6 mm.▪ Conexão de 1" BSP para conectar os sensores de validação.▪ Isolamento térmico com fibra cerâmica revestida por tecido de fibra de vidro siliconada, mais eficiente e removível em caso de manutenção.▪ Comando pro CLP com senha de proteção para edição e senha de operação.▪ Ciclos de trabalho automatizados.▪ Ciclo de teste de hermeticidade de acordo com a NBR 17.665-2 2013. Gerador de Vapor: <ul style="list-style-type: none">▪ Gerador de Vapor construído em aço inoxidável AISI 304-L, com funcionamento automático.▪ Resistências em aço inoxidável polido.					

Rua Cerejeira, 63 - Jd. Queiroz - Fone (43) 3029-1403 - CEP 86192-220 - Cambé - PR
E-mail: jaragua@jaraguamercantil.com.br | vendas@jaraguamercantil.com.br
CNPJ 13.390.706/0001-59 - Insc. Est. 905-52349-03




JARAGUÁ MERCANTIL - EIRELI.

EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES



- Potência de aquecimento 27 KW.
 - Isolamento térmico com fibra cerâmica revestida por tecido de fibra de vidro siliconada, mais eficiente e removível em caso de manutenção.
- Portas:**
- 02 (duas) portas deslizantes com movimento vertical e travamento automático.
 - O sistema de fechamento por guarnição pressurizada de silicone.
 - Sistema antiesmagamento.
- Acabamento Interno e Externo:**
- Internamente polimento sanitário.
 - Externamente o acabamento em aço inoxidável escovado.
- Comando Eletrônico:**
- O comando por Controlador Lógico Programável marca Schneider Electric.
 - **Display sensível ao toque colorido de 7" polegadas.**
 - Temperaturas programáveis de 121°C a 134°C.
 - Impressora para registro dos dados do ciclo (temperatura, pressão CI, pressão CE, operador, nome do ciclo, intercorrência, horário de início e final de ciclo e assinatura do responsável).
 - Botões liga/desliga e emergência.
 - Ciclo para Leak Test.
 - Ciclo para teste de Bowie & Dick.
 - 10 ciclos de esterilização pré-definidos (pacotes, látex, instrumental, etc.).
 - 10 ciclos de livre programação pelo usuário, mediante senha.
 - Programa para líquidos em frascos não herméticos.
 - Alarmes para avisos de falhas no ciclo, falha de suprimentos de água, ar comprimido ou falta de fase na rede elétrica.
 - Programa especial de manutenção com comando direto aos componentes da autoclave, mediante a senha de manutenção.
 - Senha para edição de programas.
 - Sistema de segurança que impede o funcionamento sob condição de falha ou falta de suprimento, assim como despressuriza a câmara interna em caso de parada de emergência.
- Unidade de Vácuo:**
- Bomba de vácuo de anel líquido com motor de 3,0 cv.
 - Nível de ruído de acordo com a NR-15.
- Válvulas de Controle:**
- As válvulas de controle de entrada de vapor, ar filtrado, vácuo, descarga e exaustão do tipo globo atuadas pneumaticamente em aço inoxidável 316-L.
 - As válvulas de entrada de água da bomba de vácuo e bomba de água, são do tipo solenoide marca Asco.
 - Válvula de exaustão de emergência do tipo globo atuada pneumaticamente.
 - Tubulações e conexões em material anticorrosivo; cobre e suas ligas e aço inoxidável.
- Válvula de Segurança:**
- Válvula de segurança calibrada em 3,5 bar, em aço inoxidável 316-L, com alavanca.
- Sistema de Osmose Reversa:**
- Sistema completo de osmose reversa com produção de 20 L/h, com reservatório.
- Filtro de Ar:**
- Filtro de ar microbiológico.
- Capacidade:**
- 250 (duzentos e cinquenta) litros.
 - Potência: 26.700 watts.
- Alimentação Elétrica:**
- Trifásico 220 volts.
 - **Opcional:** 380 volts, com neutro e terra.
- DIMENSÕES:**
- Interna:**
- Largura: 500 mm.
 - Altura: 500 mm.
 - Profundidade: 1.200 mm.
- Externa:**
- Largura: 1.000 mm.
 - Altura: 1.900 mm.



JARAGUÁ MERCANTIL - EIRELI.

EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES



- Profundidade: 1.500 mm.
- Acompanham o equipamento:**
- 02 (duas) portas deslizantes com movimento vertical e travamento automático.
- 01 (uma) Impressora incorporada no equipamento.
- 01 (um) Sistema completo de osmose reversa com produção de 20 L/h, com reservatório.
- 02 (dois) Carros externos para Rack em aço inox AISI 316.
- 01 (um) Carro interno para Rack em aço inox AISI 316.
- Manual Técnico e Operacional.
- Demais cabos, conexões e acessórios para o perfeito funcionamento do equipamento.

TOTAL GERAL DA PROPOSTA..... R\$ 211.995,00
******(Duzentos e onze mil novecentos e noventa e cinco reais)******

1. ***** CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO*****

- **Condições de Pagamento.....** : Até 30 (trinta) dias, Conforme Edital.
- **Validade da Proposta.....** : 60 (sessenta) dias, Conforme Edital.
- **Prazo de Entrega.....** : Até 60 (sessenta) dias, Conforme Edital.
- **Frete.....** : Pago (Cif).
- **I.P.I.....** : Incluso
- **Assistência Técnica.....** : Permanente, em todo Território Nacional, durante o período de Garantia, sem nenhum Ônus ao Município.
- **Garantia.....** : 12 (doze) meses, exceto o uso indevido ou desgaste natural dos equipamentos. A garantia inclui peças, serviços, taxa de deslocamento e qualquer outro custo, sem nenhum ônus para a Administração.
- **Peças de Reposição.....** : Pelo período, de no mínimo 05 (cinco) anos, mesmo que os equipamentos saiam de linhas de Fabricação, e/ou sua comercialização, após o término da garantia.
- **Local de Entrega** : Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante
: Rua Ivete Alcântara, n.º 120 – Centro
: CEP: 62.670-000 – GONÇALO DO AMARENTE / CE.
- **Responsabilidade Geral.....** : **Jaraguá Mercantil – Eireli**
: Rua Cerejeira, n.º 63 – Jardim Queiróz – Fone: (43) 3029-1403
: CEP: 86.192-220 – CAMBÉ / PR.


2. *****PROPONENTE*****

- **Jaraguá Mercantil – Eireli**
- Rua Cerejeira, n.º 63 – Jardim Queiróz
- CEP: 86192-220 – Cambé/PR.
- CNPJ: 13.390.706/0001-59
- Insc. Estadual: 90.552.349-03
- Insc. Municipal: 15.796
- Fone: (43) 3029-1403
- E-mail: vendas@jaraguamercantil.com.br / jaragua@jaraguamercantil.com.br

3. *****DADOS BANCÁRIOS*****

- Banco do Brasil (001)
- Agência: 0768-4
- C/corrente: 48036-3

Rua Cerejeira, 63 - Jd. Queiroz - Fone (43) 3029-1403 - CEP 86192-220 - Cambé - PR
E-mail: jaragua@jaraguamercantil.com.br | vendas@jaraguamercantil.com.br
CNPJ 13.390.706/0001-59 - Insc. Est. 905-52349-03



JARAGUÁ MERCANTIL - EIRELI.

EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES



- Favorecido: Jaraguá Mercantil – Eireli
- CNPJ: 13.390.706/0001-59

4. *****DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL (P/ASSINATURA DO CONTRATO)*****

- Nome: Laudinei Antonio Campos
- Estado Civil: Casado
- Profissão: Representante Comercial
- Endereço: Rua Elis Regina, n.º 217 – Jardim Bavária – CEP: 86082-015 - LONDRINA/PR.
- CPF: 857.114.549-00
- RG: 4.086.585-3 SESP/PR.
- Data de Nascimento: 28/07/1972

5. *****DECLARAÇÕES*****

- Os preços acima propostos contempla todos os custos diretos ou indiretos, já estão inclusos impostos, seguros, taxas, frete e quaisquer outros encargos, pertinentes ao fornecimento dos produtos licitados. Exceto adequação de sala e ou realização de obras de engenharia.
- Concordamos com todas as condições do presente Edital, bem como; seus anexos.

Sem mais para o momento, firmamo-nos mui,

ATENCIOSAMENTE
LAUDINEI
ANTONIO
CAMPOS:
85711454900


Assinado digitalmente por LAUDINEI ANTONIO
CAMPOS: 85711454900
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=40312993000151, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em
branco), CN=LAUDINEI ANTONIO CAMPOS:
85711454900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.08.12 11:41:04-03'02'
Formato: Roador Versão: 10.1.3

JARAGUÁ MERCANTIL – EIRELI
Laudinei Antonio Campos
CPF: 857.114.549-00
RG: 4.086.585-3 SESP/PR
Representante Legal

13.390.706/0001-59
Inscr. Est.: 90.552.349-03
JARAGUÁ MERCANTIL - EIRELI
RUA CEREJEIRA, 63
JARDIM QUEIROZ
CEP 86192-220 - CAMBÉ - PR

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	MIRAX INDUSTRIAL LTDA - ME
CNPJ	04.055.777/0001-04
Autorização	8.01.627-0
Produto	AUTOCLAVE A VAPOR MIRAX SÉRIE MV


Modelo Produto Médico
100
1000
1200
1500
160
200
2000
250
2500
300
3000
360
450
600
80
800

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
[sem dados cadastrados]		

Nome Técnico	Autoclave
Registro	80162700002
Processo	25351333872201089
Fabricante Legal	MIRAX INDUSTRIAL LTDA - ME
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	[sem dados cadastrados]

M U

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
459
SÃO CONÇALO DO AMARANTE

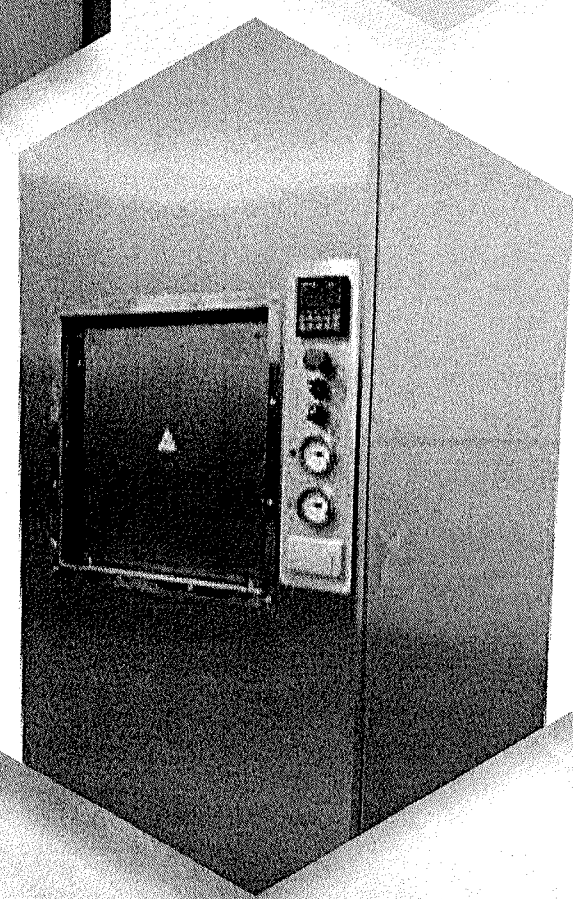

**EQUIPAMENTOS
BIOMÉDICOS
E INDUSTRIAIS**

mirax

J
ca
12

TRADIÇÃO QUALIDADE E CONFIABILIDADE

Fundada no ano de 2000, no município de Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba, no Estado do Paraná, a Mirax Industrial Ltda. foi criada com o objetivo de produzir produtos com a mais alta qualidade e confiabilidade no mercado brasileiro.

Com muitos anos de história no mercado brasileiro e clientes espalhados em todo o território nacional, adquirir uma solução Mirax é a certeza de estar levando uma marca de tradição e confiabilidade.

NOSSA MISSÃO:

Fornecer produtos e serviços biomédicos e industriais com a mais alta confiabilidade e qualidade, agregando valor aos nossos clientes e a sociedade.

NOSSOS VALORES:

Foco no cliente, Profissionalismo, Ética, Confiança, Integridade, Empreendedorismo, Dinamismo e Inovação.

CLIENTES EM TODAS AS REGIÕES DO BRASIL



EQUIPAMENTOS COM QUALIDADE E TECNOLOGIA AUTOCLAVES A VAPOR MIRAX LINHA MV

Registro na ANVISA: 80162700002

Projeto de acordo com as normas: ASME VIII Divisão I, NBR 17.665: 2013 e NR 13.


Capacidade de 80 litros a 3.000 litros.

CARACTERÍSTICAS:

- Uma ou duas válvulas de segurança calibradas.
- Câmara interna e externa, construídas em aço inoxidável AISI 316-L
- Eletroválvulas pneumáticas para as linhas de vácuo, vapor, descarga (opcional) e ar.
- Conexão de dreno e conexão de 1" BSP para sensores de validação.
- Comando por CLP com senha de proteção para edição e senha de operação.
- Duas opções de CLP: com tela sensível ao toque ou teclado de membrana.
- Impressora para registro de dados dos ciclos, com opção de impressora térmica ou matricial.
- Programas de trabalho automatizados.
- Programa de teste de hermeticidade de acordo com a NBR 17.665-2 2013.
- Programa de teste Bowie & Dick.
- Alarmes para avisos de falhas no ciclo e recomendações de manutenção.
- Uma ou duas portas do tipo deslizante automática ou volante central.
- Filtro de ar com grau microbiológico.
- Acompanham um ou dois carros internos e um ou dois carros externos em aço inoxidável, de acordo com a necessidade do cliente.
- Bomba de água e bomba de vácuo, de acordo com o volume do equipamento.

OPCIONAL:


- Eletroválvula pneumática de descarga de segurança.
- Sistema que impede a abertura da (s) porta (s) com pressão positiva acima de 0,1 BAR.
- Sistema antiesmagamento na (s) porta (s).
- Sistema de osmose reversa com reservatório. O sistema de osmose pode ser externa ou interna no equipamento.

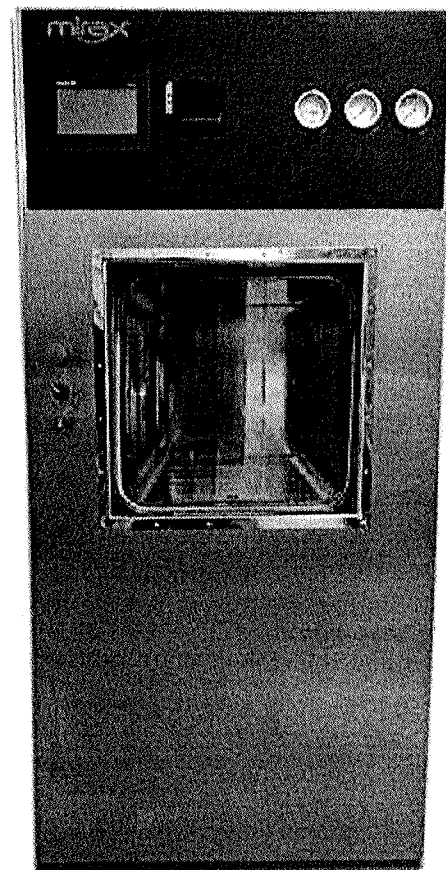

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

AMPLA GAMA DE TAMANHOS DISPONÍVEIS


O tamanho certo para sua aplicação com a linha MIRAX MV de autoclaves a vapor com 80 a 3.000 litros de capacidade com uma ou duas portas (sistema de barreira).



MODELOS MV	DIMENSÕES INTERNAS		POTÊNCIA		
	Vol. litros	LarxAltXProf (mm)	PGV (kW)	BV (CV)	TOTAL kW
MV80	80	400X400X500	10	1,5	11,6
MV100	100	400X400X625	12	1,5	13,6
MV160	160	400X400X1000	16	1,5	17,6
MV200	200	500X500X800	18	3	20,7
MV250	250	500X500X1000	22	3	24,7
MV300	300	500X500X1200	24	3	26,7
MV360	360	600X600X1000	26	3	28,7
MV450	450	600X600X1250	32	4	35,4
MV600	607	700X700X1240	40	4	43,4
MV800	808	700X700X1650	48	5	52,2
MV1000	1004	700X700X2050	52	7,5	58,0
MV1200	1215	900X900X1500	60	7,5	66,0
MV1500	1506	900X900X1860	80	7,5	86,0
MV2000	2000	1000X1000X2000	100	7,5	106,0
MV2500	2508	1120X1120X2000	120	10	127,9
MV3000	3025	1230X1230X2000	160	10	167,9



**FABRICADOS
NO BRASIL**

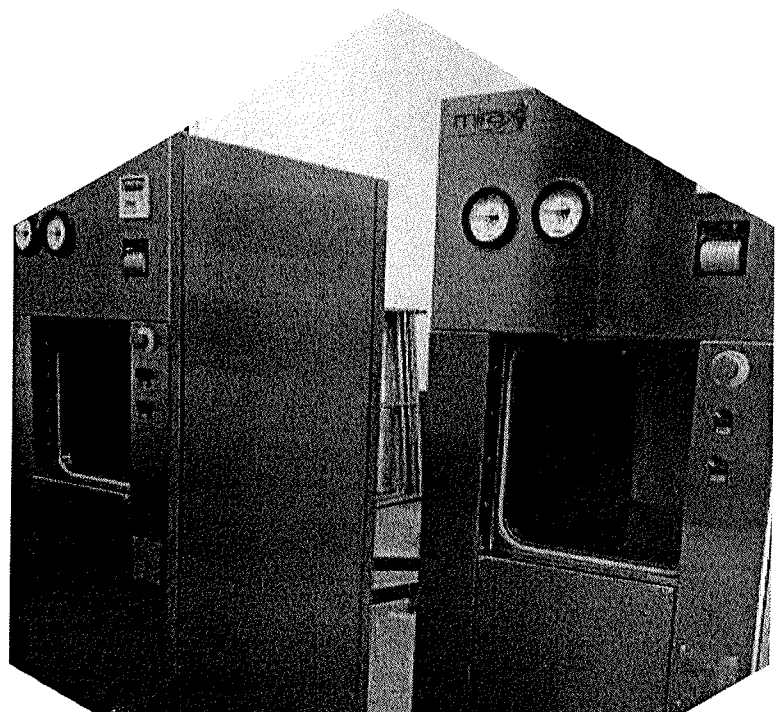


Handwritten initials and marks:
LA
R
M



SERVIÇOS MIRAX


Laboratório próprio, com equipamentos modernos e calibrados.
Validação de processos de esterilização.
Testes físicos.
Qualificação de sistemas de controles de equipamentos.
Laboratório para calibração e validação em conformidade, com o CFR 21.
Reforma e manutenção.
Qualificação de instalação e operação.

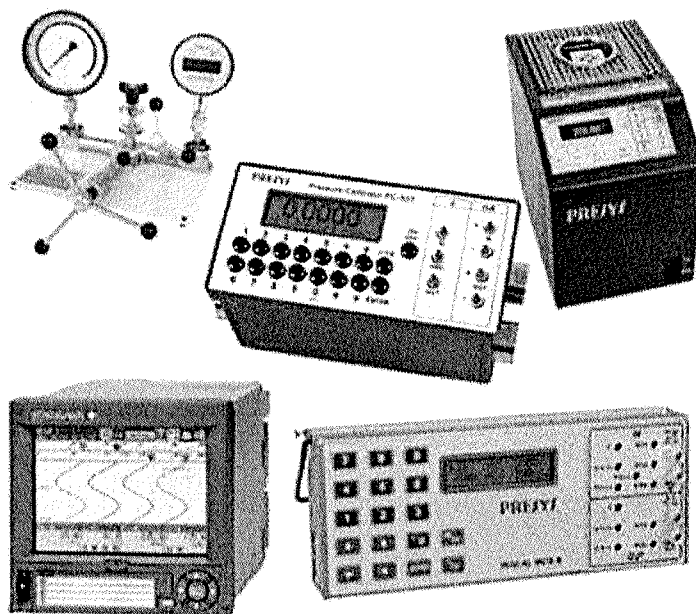


Handwritten signatures and initials.

WWW.MIRAX.COM.BR
CONTATO@MIRAX.COM.BR
+55 41 3033-5777

mirax



ESPECIFICAÇÃO VAPORIZADOR

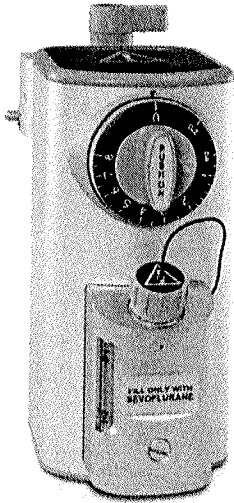

Vaporizador Penlon - Sigma Delta

Marca / Fabricante: Penlon Limited
Procedência: Reino Unido
Modelo: Selectatec
Registro no MS: 80102511421

Vaporizador Marca Penlon modelo Sigma Delta para agente anestésico Sevoflurano ou Isoflurano com sistemas de preenchimento Pour Fill, com encaixe Selectatec e sistema de proteção Interlock que impede o acionamento simultâneo de dois vaporizadores. Oferece concentrações precisas sob variação condições de fluxo e temperatura, particularmente no baixo fluxo.

DANIELE
BITTENCOURT
BARBOSA:367
30372850

Assinado de forma digital por DANIELE BITTENCOURT BARBOSA:36730372850
DN: c=DANIELE BITTENCOURT BARBOSA, o=ICP-Brasil, ou=Video Conferência, ou=30235201000139, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF-A1, ou=em branco, cn=DANIELE BITTENCOURT BARBOSA:36730372850
Dados: 2021.08.12 12:12:34 -03'00'

THAIS
BITTENCOURT
BARBOSA:3430
0046832

Assinado de forma digital por THAIS BITTENCOURT BARBOSA:34300046832
DN: c=THAIS BITTENCOURT BARBOSA, o=Video Conferência, ou=30235201000139, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF-A1, ou=em branco, cn=THAIS BITTENCOURT BARBOSA:34300046832
Dados: 2021.08.12 12:12:58 -03'00'

RESPIRATORY
CARE
HOSPITALAR
LTDA:02126465
000119

Assinado de forma digital por RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA:02126465000119
DN: c=RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA, ou=Video Conferência, ou=30235201000139, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF-A1, ou=em branco, cn=RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA:02126465000119
Dados: 2021.08.12 12:12:59 -03'00'